


IKA

designed for scientists

VN

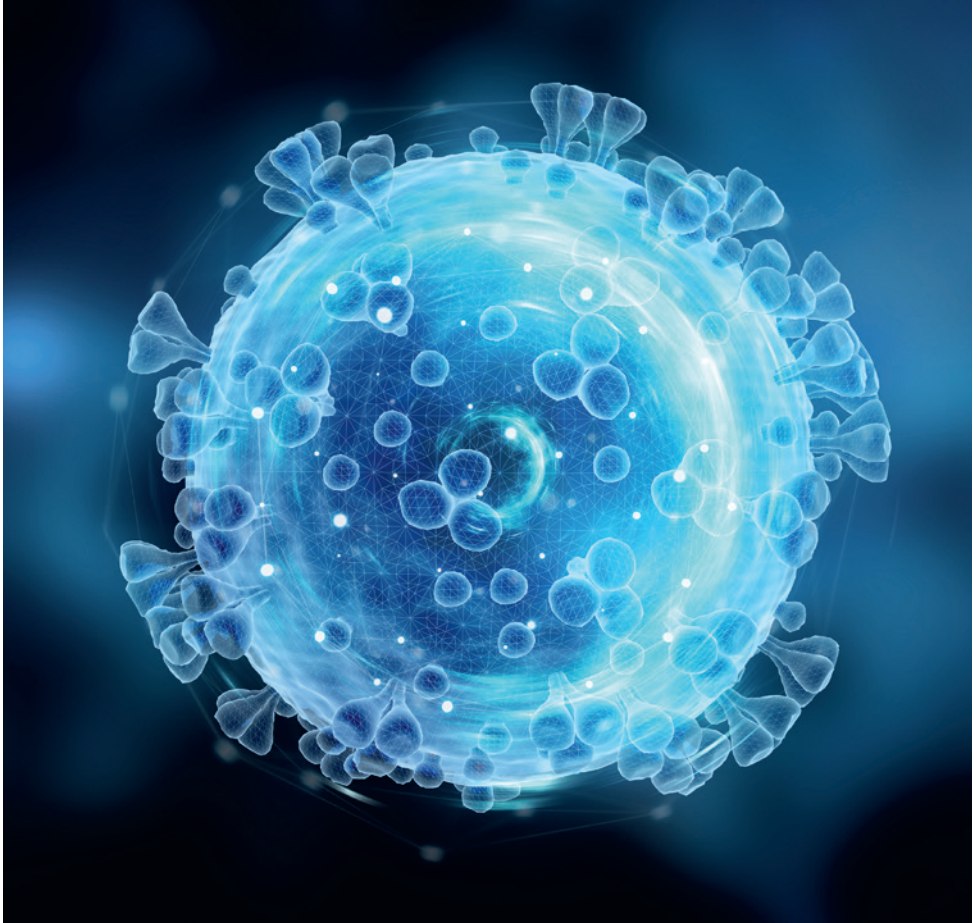

Sản phẩm được đề xuất
Đánh bại sự lây lan của COVID-19
với thiết bị thí nghiệm từ IKA

Phát hiện mầm bệnh COVID-19 thông qua RT-PCR

Chuẩn bị phân tách DNA / RNA

> 1 | Chuẩn bị mẫu



IKA PETTE
vario



IKA Tip s / xs
box

PIPETTE VÀ ĐẦU TIP PIPETTE

IKA PETTE vario 0.5 – 10 µl	0020011211	VND 4,857,000
IKA PETTE vario 100 – 1000 µl	0020011216	VND 4,857,000
IKA Tip xs box + (DNA/RNase miễn phí)	0020017820	VND 8,367,000
IKA Tip s box + (DNA/RNase miễn phí)	0020017824	VND 8,367,000

DNA/RNase lọc
đầu tips miễn phí



MÁY LẮC

Roller shaker Roller 6 basic	0004010000	VND 49,950,000
Roller shaker Roller 6 digital	0004011000	VND 55,219,000
Roller shaker Roller 10 basic	0004012000	VND 59,331,000
Roller shaker Roller 10 digital	0004013000	VND 66,118,000
Orbital shaker Vortex 3	0003340000	VND 9,180,000



Roller 6 digital



Vortex 3

> 2 | Ly giải

Kết quả trộn
tối ưu cho khối
lượng nhỏ nhất



PIPETTE VÀ ĐẦU TIP PIPETTE

IKA PETTE vario 0.5 – 10 µl	0020011211	VND 4,857,000
IKA PETTE vario 100 – 1000 µl	0020011216	VND 4,857,000
IKA Tip xs box + (DNA/RNase miễn phí)	0020017820	VND 8,367,000
IKA Tip s box + (DNA/RNase miễn phí)	0020017824	VND 8,367,000

MÁY LẮC GIA NHIỆT

Matrix Orbital Δ F1.5	0030000750	VND 81,224,000
Matrix Orbital Δ F2.0	0030000753	VND 81,224,000

> 3 | Làm tinh & tách chiết

Lý tưởng cho
tất cả các quá
trình phân tách



IKA mini G



IKA G-L

MÁY LY TÂM VÀ ROTOR

IKA G-L	0030000774	VND 36,115,000
IKA G-L, 2 ml rotor set	0030001333	Giá vui lòng liên hệ
IKA G-L, PCR Set	0030001345	VND 6,763,000
IKA G-L, Adapter PCR tube	0030001346	VND 302,000
IKA mini G	0003958000	VND 11,063,000

Xử lý an toàn các mẫu truyền nhiễm

Phát hiện mầm bệnh COVID-19 trong phân

> Đồng nhất hóa mà không bị nhiễm chéo



ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control

HỆ THỐNG PHÂN TÁN DÙNG MỘT LẦN VÀ BUỒNG PHÂN TÁN

<i>Hệ thống phân tán dùng một lần</i> ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control	0025005981	VND 41,112,000
<i>Buồng phân tán 50 ml có rotor</i> DT-50-M-gamma, 10 pcs.	0003701600	VND 3,695,000
<i>Buồng phân tán 300ml có cánh phân tán</i> DIS-300-S-M.10, 10 pcs.	0020016318	VND 4,950,000
<i>Buồng phân tán 300ml có cánh phân tán</i> DIS-300-S-M.50, 50 pcs.	0020017313	VND 23,984,000

Buồng phân tán 50ml vô trùng, sử dụng một lần



DT-50-M-gamma



DIS-300-S-M.10
DIS-300-S-M.50

Khử nhiễm thông qua sử dụng nhiệt

Tái sử dụng khẩu trang có chức năng lọc tối đa 3 lần

> Khử nhiễm

Áp dụng nhiệt khô để khử nhiễm mặt nạ FFP2 / FFP3



IKA Oven 125 control - dry

TỦ SẤY

Tủ sấy

IKA Oven 125 basic - dry

0020003215 VND 44,830,000

Tủ sấy có cửa kính

IKA Oven 125 basic - dry glass

0020003956 VND 52,035,000

Tủ sấy

IKA Oven 125 control - dry

0020003990 VND 73,415,000

Tủ sấy có cửa kính

IKA Oven 125 control - dry glass

0020003996 VND 80,620,000



IKA Oven 125 basic - dry glass

Thuốc thử để chuẩn bị mẫu

Sản xuất dung dịch đệm và dung dịch tẩy rửa dễ dàng

> Trộn



EUROSTAR 100 / 400 control

MÁY KHUẤY ĐUÑA VÀ MÁY KHUẤY TỪ

Máy khuấy đũa EUROSTAR 100 control	0004028500	VND 69,350,000
Máy khuấy đũa EUROSTAR 400 control	0004214100	VND 117,990,000
Máy khuấy đũa RW 47 digital	0004050000	VND 151,920,000
Máy khuấy từ không gia nhiệt Maxi MR 1 digital	0025002978	VND 85,523,000

Máy khuấy mạnh
mẽ lên đến 150 l



Maxi MR 1 digital

Trong nháy mắt Thử nghiệm SARS-CoV-2

> 1 | Bệnh nhân bị bệnh và ví dụ như ho, sốt và cảm thấy yếu



Ho




Sốt



Cảm thấy yếu


> 2 | Bác sĩ lấy dịch ở cổ họng sâu và ngoáy mũi



> 3 | Gạc với vật liệu mẫu được gửi đến phòng thí nghiệm trong một ống nhựa



> 4 | Vỏ virus phải được chia nhỏ với ví dụ: Vortex 3 để thâm nhập vật liệu di truyền (RNA) bên trong (ly giải). Sau đó, mẫu này cần được thanh lọc và trích xuất với: một pipet IKA PETTE cho phân tích PCR tiếp theo.



> 5 | RNA virus phải được phiên mã thành cDNA để phân tích PCR.




Mẫu bệnh phẩm

Mẫu được chuyển đổi qua cDNA

> 6 | Các môi từ vật liệu di truyền coronavirus trong phòng thí nghiệm được thêm vào mẫu.

Mẫu được gia nhiệt và làm lạnh nhiều lần



Dương tính:

Vật liệu di truyền coronavirus gắn vào mẫu bệnh nhân...

... tức là DNA nhân lên



Âm tính:

Vật liệu di truyền coronavirus không gắn vào mẫu bệnh nhân,...


... tức là DNA không nhân lên

Sản phẩm bổ sung


Nếu được yêu cầu, các thiết bị IKA sau đây có sẵn cho phòng thí nghiệm của bạn để bổ sung cho các hoạt động giúp đánh bại sự lây lan của COVID-19.



Bộ gia nhiệt khối khô
3 x DB 6.1 (đối với dải ống PCR)
Mã số 0004470400



Dry Block Heater 3
Bộ gia nhiệt khối khô
Mã số 0004025300



Trayster digital
Máy lắc
Mã số 0004006000



Loopster basic
Máy lắc
Mã số 0004015000

Phụ kiện khác



LINEA Giá đỡ Pipette

Giá đỡ an toàn cho pipet để dễ dàng thao tác khi sử dụng thường xuyên
Mã số 0020018987



VG 3.3 Giá lắc

Giá lắc, 150 mm cho Vortex 3 cho miếng dính cao su.
Mã số 0003342400



Phần mềm hiệu chuẩn Pipette

IKA cung cấp một phần mềm hiệu chuẩn pipet thân thiện với người dùng để lập kế hoạch, thực hiện và ghi lại tất cả các bài kiểm tra hiệu chuẩn.
Mã số 0020022141

Tìm thêm phụ
kiện trên
www.ika.com

CÔNG TY TNHH IKA VIỆT NAM

P1401, 14th floor, Citilight Tower, No. 45 Vo Thi Sau Street District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: +84 28 38202142, Fax: +84 28 38202144
eMail: sales.lab-vietnam@ika.com



www.ika.com



IKASoutheastAsia // #lookattheblue